Gilian 10i GUIA RAPIDA

Este manual cubre las especificaciones, precauciones y operación básica. Para una completa información, incluyendo la operación detallada, opciones y otros detalles, vea el Manual de Operación (PN 360-0181-01). Las precauciones, el uso seguro, las instrucciones de instalación y mantenimiento de este manual deben tenerse en cuenta en todo momento.

Precauciones:

La bomba es intrínsicamente segura para uso en áreas designadas en el listado de especificaciones de la pagina 4. No cambie o cargue las baterías en zonas con peligro de explosión. Cargue las baterías completamente antes de cada uso. La batería no requiere descargas o condiciones especiales. Use solo el cargador específico, y cargue solamente dentro del rango de temperatura.

Guía de Uso

Uso del Teclado



Power/Enter: Presione un momento para encender. Mientras que si presionamos durante cinco segundos se apaga. También es usado para confirmar entradas o ajustes en el menú.

Set/Cal: Se usa para ajustar el caudal (FLO) o la calibración (CAL)

▲/Clear: Se usa en el modo de configuración para incrementar los valores mostrados en la pantalla. Se usa también para borrar los datos acumulados antes de iniciar un nuevo muestreo cuando le mantenemos presionado durante 5 segundos.

▼/Run/Stop: Se usa en el modo de configuración para disminuir los valores mostrados en la pantalla. También se usa para comenzar o para el muestreo cuando le mantenemos presionado durante 15 segundos.

Encendido y Apagado de la Bomba

ENCENDER: Presionar Power/Enter durante un momento para encender la bomba. La pantalla muestra brevemente todos los segmentos e indicadores del display la revisión de software, el número de horas desde la ultima calibración, luego entra el modo Preparada.


APAGAR: Mientras la bomba esta en el modo Preparada (no en funcionamiento), presionar y mantener Power/Enter durante unos segundos, hasta que la pantalla muestre “OFF”. Después de unos segundos la bomba se apagara.

Ajuste del caudal:

1 Mientras la bomba esta en modo Preparada, presionar una vez la tecla SET. Se mostrara "FLO" .
2 Presionar ENTER para comenzar a cambiar el caudal.
3 Presionar y mantener la tecla ▲ para incrementar el caudal o la tecla ▼ disminuir el caudal.
4 Cuando alcanzamos el caudal deseado presionar ENTER. El Tiempo Transcurrido y el Volumen Total son borrados en esta operación.

Calibración del caudal

Conectar la bomba al equipo de calibración tal como un GILIBRATOR como se muestra en la figura de abajo.

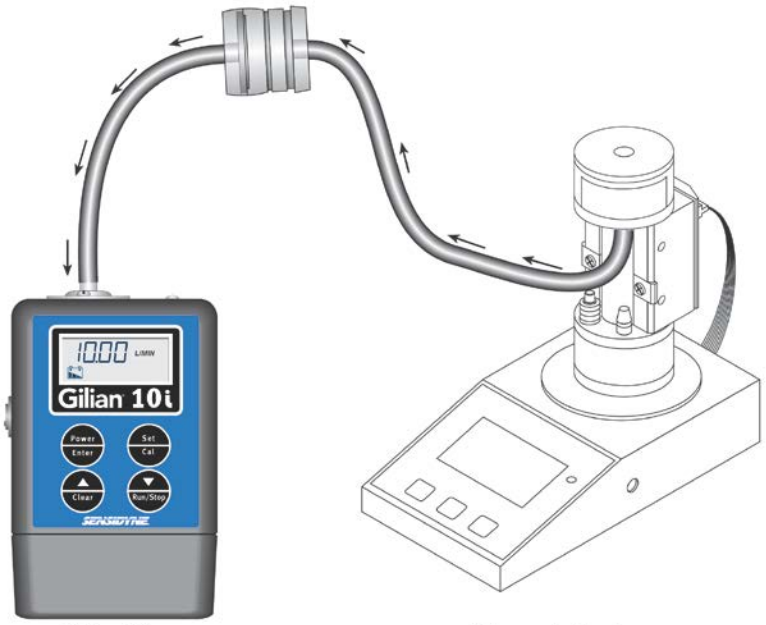

Gilian 10i — Primary Calibrator

1 Mientras la bomba esta en modo preparada, presionar SET/CAL dos veces, La pantalla mostrara "CAL".
2 Presionar ENTER para entrar en el modo de calibración. "SCAL" aparecerá durante 10 segundos, entonces, arranca el motor de la bomba. El ajuste de caudal aparece en pantalla.
3 Medir el caudal usando un equipo de referencia.
4 Ajuste la bomba hasta que coincida el caudal mostrado con el correcto. Presionar y mantener la tecla ▲ para incrementar. Presionar y mantener la tecla ▼ para disminuir.
5 Cuando el display de la bomba coincida el caudal real presionar la tecla SET. El motor de la bomba continúa funcionando y ajusta su velocidad al caudal seleccionado. La pantalla cambia y muestra el caudal original.
6 Continue la medida del caudal. Si en la pantalla de la bomba no coincide con el caudal medido por unos pocos cc/m, Puede repetir los pasos 4 y 5 hasta que la pantalla muestre el caudal actual. Cuando la pantalla coincide el caudal actual ir al paso 7.
7 Presionar ENTER otra vez para completar la calibración. La bomba se para antes de volver al modo de reposo.

Nota para calibración en campo:

El procedimiento de calibración descrito arriba sirve para ajustar internamente la bomba y mejorar la precisión del mostrado en pantalla. Esto no reemplaza a la calibración en campo como esta descrito por OSHA y NIOSH. Verifique el caudal usando el GILIBRATOR, con el mismo tren de muestreo, debe realizarse antes y después de cada muestra. El procedimiento para la calibración en campo esta referenciada en el Manual de Métodos Analíticos de *NIOSH en* www.cdc.gov/niosh o en el Manual Técnico de *OSHA en* www.osha.gov.

Comienzo de la Toma de Muestra

NOTA: EL Tiempo Total de muestreo y el Volumen Total Muestreado son acumulados de una muestra a la siguiente a menos que cambie el caudal, borre los datos o calibre la bomba. Si quiere borrar los valores antes de comenzar un muestreo, vea la sección de borrado de datos de muestreo.

Asegúrese que la bomba esta totalmente cargada, que el caudal es el adecuado, y que la bomba será calibrada usando el correspondiente tren de muestreo. Asegúrese que los tubos filtros y conexiones están correctamente instalados.

- Presione y **Mantenga** "▼/Run/Stop" hasta que aparezca "SCAL" , luego suelte la tecla. El motor de la bomba arrancara 10 segundos después. **Nota:** "SCAL" indica que la bomba esta hacienda un Ajuste Interno. Este auto-ajuste ocurrirá durante el transcurso de la muestra una vez por hora si la temperatura cambia más de 3ºC. Mientras la bomba esta en el modo SCAL, la bomba no estará operativa y el reloj se mantendrá parado.

Parada de la Toma de Muestra

- Presione y **Mantenga** "▼/Run/Stop" hasta que el motor de la bomba se pare.

Borrado de Datos de la Muestra

- Presione y **Mantenga** CLEAR durante 8 segundos. Aparecerá en pantalla "CLr", y permanecerá parpadeando los 8 segundos.

Mantenimiento

Batería

La bomba GILIAN 10i usa baterías recargables de Níquel-Metal-Hidruro, que deben cargarse completamente y mantenidas correctamente para proporcionar el máximo tiempo de muestreo. El paquete de baterías se carga completamente en menos de 4 horas. Cerciórese que el conector del cargador esta completamente insertado en el paquete de baterías. Después de cargar completamente la batería asegúrese de tapar el conector con la tapa de goma para su protección.

Filtro de entrada

Cambie el filtro de entrada cuando este sucio o dañado. Para acceder al filtro, retire los dos tornillos que sobresalen (frontal y trasero) del porta filtro, luego levante la cubierta del filtro. Inspeccione la junta y reemplácela si fuese necesario; asegúrese que queda correctamente colocada cuando vuelva a montarle.

Especificaciones:

Rango de Operación Alto Caudal	4.0-10.00 L/min
Control Caudal Constante	Mejor que ± 5% del flujo establecido después de la calibración
Compensación a Caudal Constante	Entre 4-10 LPM hasta las presiones enumeradas a continuación; 10L hasta 12” columna de agua 9L hasta 18” columna de agua 8L hasta 22” columna de agua 7L hasta 28” columna de agua 6L hasta 34” columna de agua 5L hasta 40” columna de agua 4L hasta 45” columna de agua
Dimensiones	3.2” (W)(8,1cm)x 5.4” (H)(13,7cm) x 2.3” (D)(5,8cm)
Peso	19.5 oz.(553 gr.)
Batería	Desmontable, Sellada, NiMH carga independiente de estar montada en la bomba
Tiempo de Funcionamiento	8 horas a máxima carga (4000cc/min @ 30”)
Tiempo de Carga	< 4 horas **(Use solo Sensidyne PN 298-0013-01)**
Seguridad Intrínseca	
US/Canada (Certificación Zonas	Clase I, Div 1, Grupos A, B, C, D
Con Riesgo de Explosión)	Clase II, Grupos E, F, G Class III, T4 Ta= -20°C to 45°C FM17US0133 FM17CA0073
Europa	ATEX II 1 G, Ex ia IIC T4 Ta= -20°C to 45°C FM 07ATEX0018 IECEx FMG17.0013
EMC EMI/RFI	EN61326-1:2013 FCC Part B, Class A IECS-003 Class A
Temperatura de Operación	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenaje	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
Temperatura de Carga	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Humedad de Operación	0–85 %RH, no condensante
Humedad de Almacenaje	0–98 %RH, no condensante

Servicio Tecnico:

USA
Sensidyne, LP
1000 112th Circle N, Suite 100
St. Petersburg, Florida 33716 USA
800-451-9444•727-530-3602
727-539-0550 [fax]
727-538-0671 [service fax]
e-mail: info@Sensidyne.com
web: www.Sensidyne.com

SENSIDYNE®

Representante Autorizado en la UE

1000 112th Circle N, Suite 100
St. Petersburg, FL 33716 USA
(800) 451-9444 • (727) 530-3602
(727) 539-0550 [FAX]
www.Sensidyne.com

Schauenburg Electronic Technologies GmbH
Weseler Str. 35 • 45478
Mülheim-Ruhr Germany
+49 (0) 208 9 99 10 • +49 (0) 208 5 41 10 [fax]
www.Schauenburg.com